


PET検査の時間管理を従事者で共有 リアルタイムに検査室内の状況確認が可能に

Bridgea
TIMER

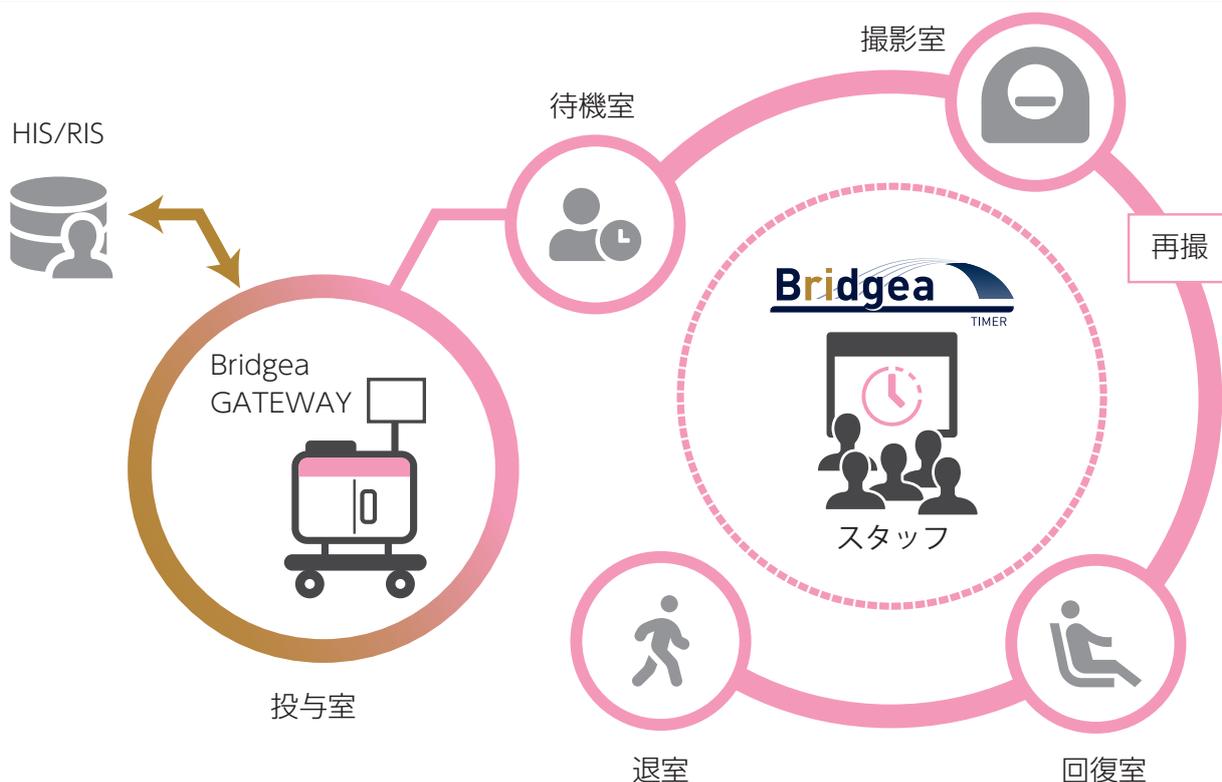

現在の検査状況を医師、技師、看護師、放射線科受付など複数の場所で共有できます。後期像撮影、待機室の空き状況、投与からの経過時間を認識しやすいレイアウトで表示します。検査の効率化と正確さにお役立てください。

PET検査の時間管理システム

投与後 60 分に対する
残り時間

撮像開始までの
残り時間

再撮指示

投与後
経過時間

Bridgea		2023/04/14		15:39:11									
882103632592	F 1983/01/21	326.9 MBq	86.1 kg	000 mg/dl	投与室	30 15	待機室	5	撮影室	回復室	再撮	退出	162 分
検査 被検者 2		12:56		1	S		1				<input checked="" type="checkbox"/>		
882103632592	M 1983/01/21	161.6 MBq	43.5 kg	000 mg/dl	投与室	30 15	待機室	5	撮影室	回復室	再撮	退出	131 分
検査 被検者 3		13:27		2	G		2				<input type="checkbox"/>		
002103633592	M 1963/06/20	321 MBq	48.2 kg	000 mg/dl	投与室	30 15	待機室	5	撮影室	回復室		退出	59 分
検査 被検者 4		14:39		3							<input type="checkbox"/>		
002443633592	M 1963/06/20	267.1 MBq	87.4 kg	000 mg/dl	投与室	30 15	待機室	5	撮影室	回復室		退出	40 分
検査 被検者 5		14:58		4							<input type="checkbox"/>		

- Bridgea INJECTOR、Bridgea GATEWAYと自動連携
- 残り時間を自動音声アナウンスでご案内
- 情報は自動再読み込み(自動リフレッシュ)
- スタッフ間の意思疎通をわかりやすく支援



製造販売元

PDRファーマ株式会社

文献請求先及び問い合わせ先 TEL 03-3538-3624
〒104-0031 東京都中央区京橋2-14-1 兼松ビルディング

2023年11月作成
12311010Z
FDG-2-016